



EN

WKB008
Instruction Manual
WE-2022-WKB008-1


ELECTROSTIMULATION

The company reserves the right to amend the details of the instruments with no prior notice. If any mistakes are found in these instructions, please feel free to send us an e-mail informing us so that we can correct them.

PACKAGE CONTENTS


- These components are subject to change without prior notice.
- Appearance of product may differ from the image.

No.	PRODUCT	REF.	CANT.
1	BIG ELECTRODES	-	10
2	SMALL ELECTRODES	-	10
3	CABLES WITH 10 OUTPUT CONNECTORS	-	2
4	ELASTIC BELTS WITH VELCRO	-	20
5	MAIN UNIT	-	1
6	POWER CORD	-	1

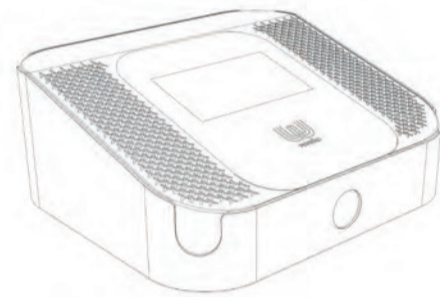

INSTRUCTIONS OF USE

1. Connect the power cord via the rear panel.
2. Connect the cables of the electrodes properly to the rear panel. Follow the numerical instructions, connector with cables from 5 to 9 is to be plugged on the left and from 0 to 4 to be plugged on the right.
3. Clean the skin with some alcohol before placing the electrodes. Place them on the desired areas: small electrodes are for small areas such as arms, abdomen and shoulders and big ones for legs and back.

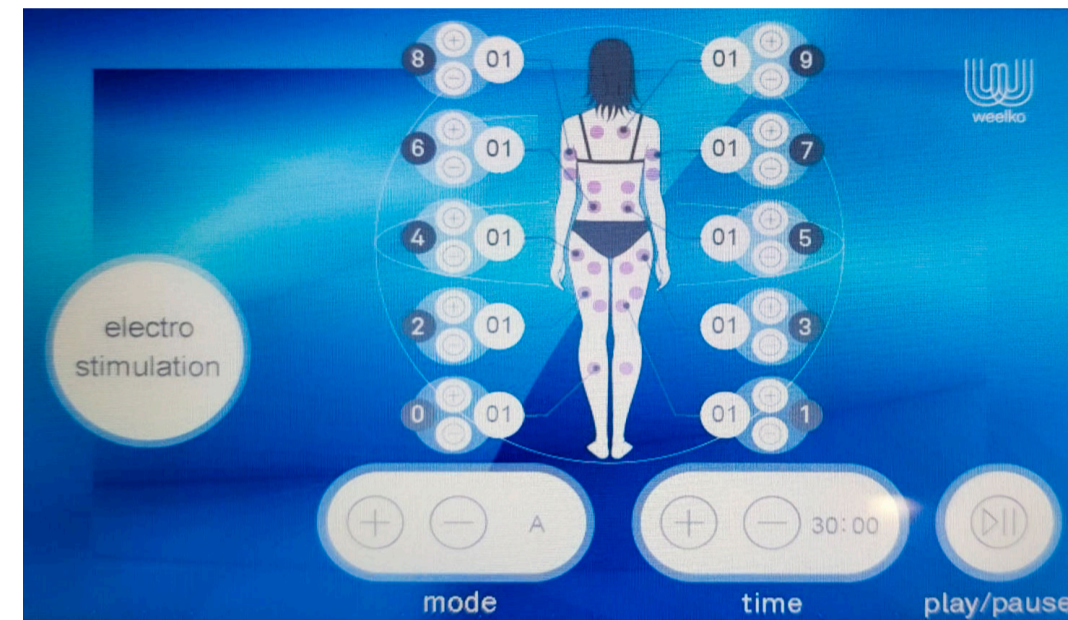

8. The "LEVEL" menu allows to adjust intensity. It can be independently adjusted on each electrode from 1 to 15. In case of programs C and D, the intensity is enough for a functional activity until the contraction is visible.
9. The "TIME" menu allows to adjust the treatment time. In case of programs A and B the recommended time is 45 min. In case of programs C and D, the recommended time is 20-30 min. maximum.
10. Press "PLAY/PAUSE" to begin or pause the treatment.

CAUTIONS

- During the treatment, check with the patient if the current is appropriate.
- Make sure the current is at the minimum intensity before pressing on PLAY and increase intensity very progressively.
- Do not remove the electrodes from the skin before turning the machine completely off.

MAINTENANCE

- Connect and disconnect the electrodes carefully to extend the product lifetime. Only the general power cord at the rear part of the device should be connected and disconnected.
- After use, clean the electrodes with a wet cloth and some disinfecting product.

ACCESSORIES

REF.	DESCRIPCIÓN
-	EMS BIG ELECTRODES
-	EMS SMALL ELECTRODES
-	EMS CABLE
-	EMS ELASTIC BELTS

WARNING


- Never under any circumstances attempt to open or inspect the internal components or accessories of the machine. If an inspection becomes necessary, please contact your supplier or a suitably competent technician.
- Never use the unit in humid or poorly ventilated environments, such as wet rooms, bathrooms, etc. to prevent damage to the electrical components of your unit.
- Never use the unit outdoors; exposure to the elements can cause damage.
- If the power cord was destroyed, please ask a professional to service and replace it to avoid hazards, or contact the dealer for service.
- Do not use on pregnant women, on people with pace-makers (any electrical or rhythmic heart-regulating device) or with skin infections.

EC-DECLARATION OF COMPLIANCE

This product meets the following requirements:




1. Conditions set out in the Low Voltage Directive: 2014/35/EU
2. Conditions set out in the Electromagnetic Compatibility Directive: 2014/30/EU

RECYCLING

 Whenever any of our electrical products or their presentation packaging bear this symbol, it means that these products should not be treated as conventional household waste in Europe. To ensure proper treatment of this waste, dispose of it in accordance with local laws or as required for the disposal of electrical equipment. This initiative will help preserve save natural resources and improve standards of environmental protection in regard to the treatment of electrical waste.

WELCOME!

Thank you very much for purchase. Please read the instructions carefully before operating the instrument. You can also ask a professional for guidance to make sure you are using the instrument correctly. We will accept no responsibility for any accidents that occur due to incorrect operation.

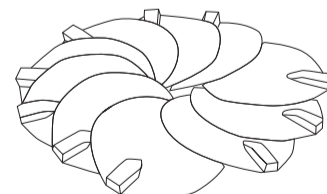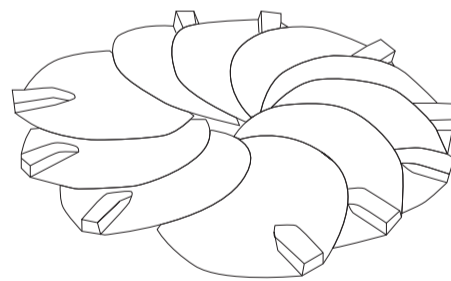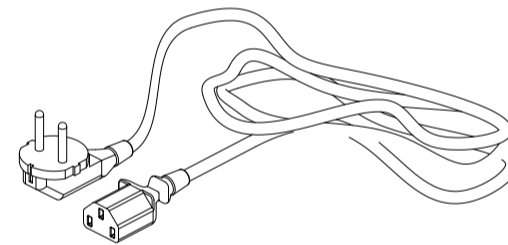

4. The red cable is the positive pole and has to be placed on the motor point or the muscle belly. The black cable will be the negative pole and will be placed on the electrode close to the muscle insertion. Use conductive gel on the electrode before placing them in contact with the skin.
5. Use the elastic belts to hold the electrodes in touch with the skin.
6. Turn on the power button on the front panel and click on Weelko logo to select the desired menus.
7. Select "electrostimulation" menu to start with the treatment.

TECHNICAL SHEET

Weights and sizes	Packing size (cm)	52x45x23
	Gross weight (Kg)	8
	Product size (cm)	38x34x15
Working characteristics	Rated power	50 W
	Working power	15 W
	Working frequency EMS	10-40Hz
	Pulsed microcurrent EMS	50mA
Electrical characteristics	Rated voltage	220V ~ 240V
	Frequency	50Hz/60Hz
	Rated power	50 W



ES

WKB008
Manual de Instrucciones
WE-2022-WKB008-1

ELECTROESTIMULACIÓN

ADVERTENCIA

• Nunca, en ninguna circunstancia, intente abrir o inspeccionar los componentes o accesorios internos de la máquina. Si fuera necesaria una inspección, por favor póngase en contacto con su proveedor o un técnico debidamente cualificado.

• No utilice nunca la unidad en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados, como zonas de aguas, baños, etc., con el fin de prevenir daños en los componentes eléctricos de su equipo.

• Nunca utilice el equipo al aire libre, las inclemencias meteorológicas pueden causar daños.

• Si el cable eléctrico estuviera roto, solicite a un profesional que le suministre otro y lo cambie para evitar riesgos, o contacte con el proveedor.

• No utilice el equipo con mujeres embarazadas, pacientes con epilepsia, pacientes con dispositivo de control de ritmo cardíaco (marcapasos) o pacientes con una infección cutánea.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:

1. Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2014/35/EU

2. Las medidas de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2014/30/EU

CONTENIDO DEL PAQUETE

• Estos componentes están sujetos a cambio sin previo aviso.

• El aspecto del producto puede diferir de la imagen.

No.	PRODUCT	REF.	CANT.
1	ELECTRODOS GRANDES	-	10
2	ELECTRODOS PEQUEÑOS	-	10
3	CABLES CON 10 CONECTORES	-	2
4	BANDAS ELÁSTICAS CON VELCRO	-	20
5	UNIDAD PRINCIPAL	-	1
6	CABLE ALIMENTACIÓN	-	1


INSTRUCCIONES DE USO

1. Conecte el cable de alimentación en el panel trasero.

2. Conecte correctamente los cables en el panel trasero. Siga las indicaciones: un conector para los cables del 0 al 4 y otro para los del 5 al 9.

3. Limpie la piel con alcohol antes de colocar los electrodos en las áreas deseadas. Los pequeños son para las áreas de dimensiones menores como brazos, abdomen y hombros, y los grandes para las piernas y la espalda.

4. El cable rojo es el polo positivo y tiene que ponerse en un punto motor o en el músculo del abdomen. El cable negro es

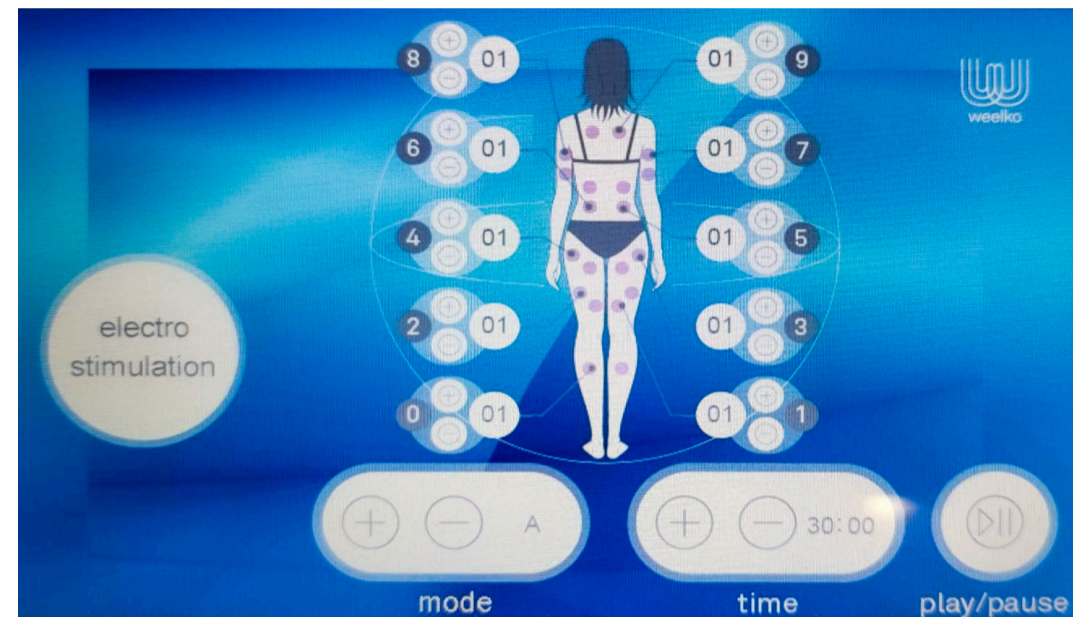

el polo negativo que se coloca cerca de la intersección del músculo. Poner gel conductor en los electrodos antes de ponerlos en contacto con la piel.

5. Utilice las bandas elásticas para sujetar los electrodos a la piel.

6. Encienda el botón en el panel frontal y haga clic en el logo Weelko de la pantalla para proceder a seleccionar los menús deseados.

7. Seleccione "EMS" para tratamientos de electroestimulación.

8. El menú "LEVEL" permite ajustar independientemente la intensidad de cada electrodo del 1 al 15. El menú "MODE" permite elegir la frecuencia de trabajo dentro de 4 programas, el A, B, C

y D. En el caso de los programas C y D, la intensidad es suficiente para una actividad funcional hasta que la contracción muscular es visible.

9. En el menú "TIME" podemos ajustar la duración del tratamiento. En el caso de los programas A y B el tiempo recomendado son 45min, i en los programas C y D, el tiempo recomendado son 20-30 minutos máximo.

10. Clica "PLAY/PAUSE" para empezar o pausar el tratamiento.

PRECAUCIÓN

• Durante el tratamiento, consulte con el cliente si la intensidad eléctrica es la adecuada.

• Se recomienda que el paciente beba mucha agua antes y después del tratamiento.

• Asegúrese de que la intensidad de la corriente esté al mínimo antes de presionar PLAY, y aumentar la intensidad progresivamente.

• No quite los electrodos de la piel antes de apagar completamente el equipo.

MANTENIMIENTO

• Conecte y desconecte los electrodos con cuidado para alargar su vida útil. Conecte y desconecte solamente el cable general de la parte trasera.

• Limpie los electrodos con un trapo húmedo y producto desinfectante.

ACCESORIOS

REF.	DESCRIPTION
-	EMS ELECTRODOS GRANDES
-	EMS ELECTRODOS PEQUEÑOS
-	EMS CABLE
-	EMS BANDAS ELÁSTICAS

FICHA TÉCNICA

Pesos y tamaños	Tamaño embalaje (cm)	52x45x23
	Peso bruto (Kg)	8
	Tamaño consola (cm)	38x34x15
Características de trabajo	Potencia nominal	50 W
	Potencia de trabajo	15 W
	Frecuencia de trabajo EMS	10-40Hz
	Microcorriente pulsada EMS	50mA
Características eléctricas	Voltaje nominal	220V ~ 240V
	Frecuencia	50Hz/60Hz
	Potencia nominal	50 W

RECICLAJE






Cuando aparezca este símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos o su embalaje, esto significa que dichos productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en Europa. Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio ambiente y mejorar los estándares de protección medioambiental en relación con el tratamiento de residuos eléctricos.

¡BIENVENIDO!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un manejo incorrecto.

La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.

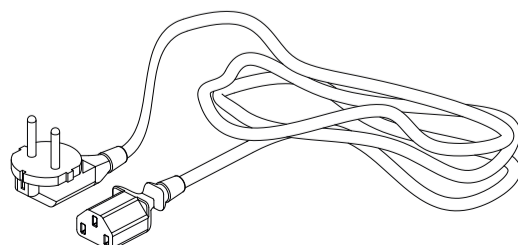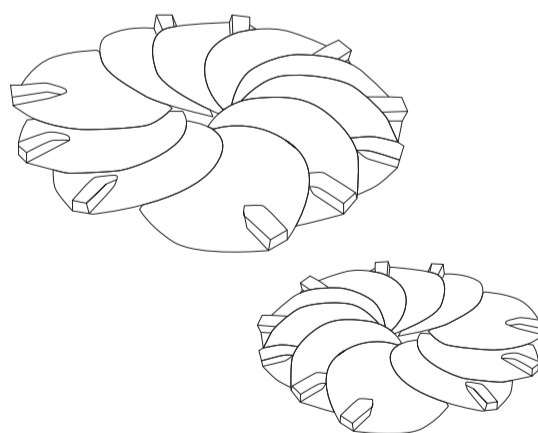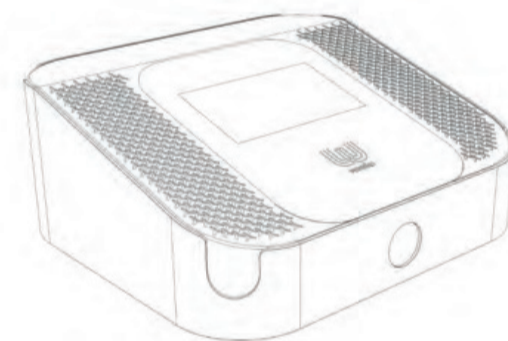



FR

WKB008
Mode d'emploi
WE-2022-WKB008-1

ÉLECTROSTIMULATION

ADVERTISSEMENT

• N'essayez en aucune circonstance d'ouvrir ou d'inspecter les composants internes ou les accessoires de votre appareil. Si une inspection est nécessaire, veuillez contacter votre fournisseur ou un technicien qualifié.

• N'utilisez jamais votre appareil dans un lieu humide ou peu ventilé (par exemple, salles de bains); ceci pourrait endommager les composants électriques de votre appareil.

• N'utilisez jamais votre appareil à l'extérieur, une exposition aux éléments naturels pouvant endommager l'appareil.

• Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.

• N'utilisez pas l'appareil avec femmes enceintes, patients avec épilepsie, patients avec un stimulateur cardiaque ou patients avec une infection cutanée.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce produit répond aux exigences suivantes:

1. Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2014/35/EU

2. Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2014/30/EU

RECYCLAGE



Si l'un des composants électriques ou leur emballage de présentation porte ce symbole, cela signifie que ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers habituels.

Afin de leur assurer un traitement approprié, veuillez vous en débarrasser en respectant les lois locales ou tel que requis en cas d'élimination d'appareils électriques. Ceci permettra de préserver et de sauver les ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement portant sur l'élimination de déchets électriques.

BIENVENUE!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.

L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

• Ces éléments sont sujets à changement sans préavis.

• L'apparence du produit peut différer de l'image.


No.	PRODUCT	REF.	QTE.
1	ÉLECTRODES TAILLE GRANDE		10
2	ÉLECTRODES TAILLE PETITE		10
3	CÂBLES AVEC 10 CON- NECTEURS DE SORTIE		2
4	BANDES ÉLASTIQUES AVEC FERMETURE VELCRO		20
5	UNITÉ PRINCIPALE	-	1
6	CÂBLE ALIMENTATION	-	1

MODE D'EMPLOI

1. Branchez le cordon d'alimentation sur le panneau arrière.

2. Branchez les câbles des électrodes correctement sur le panneau arrière. Suivez les instructions numériques. Le connecteur avec les câbles du 5 au 9 doit être branché à gauche ; et du 0 au 4 à droite.

3. Nettoyez la peau avec de l'alcool avant d'appliquer les électrodes. Appliquez-les sur les zones désirées : les petites électrodes sont pour les petites surfaces comme les bras, l'abdomen ou les épaules ; les grandes sont à utiliser sur les jambes et le dos.

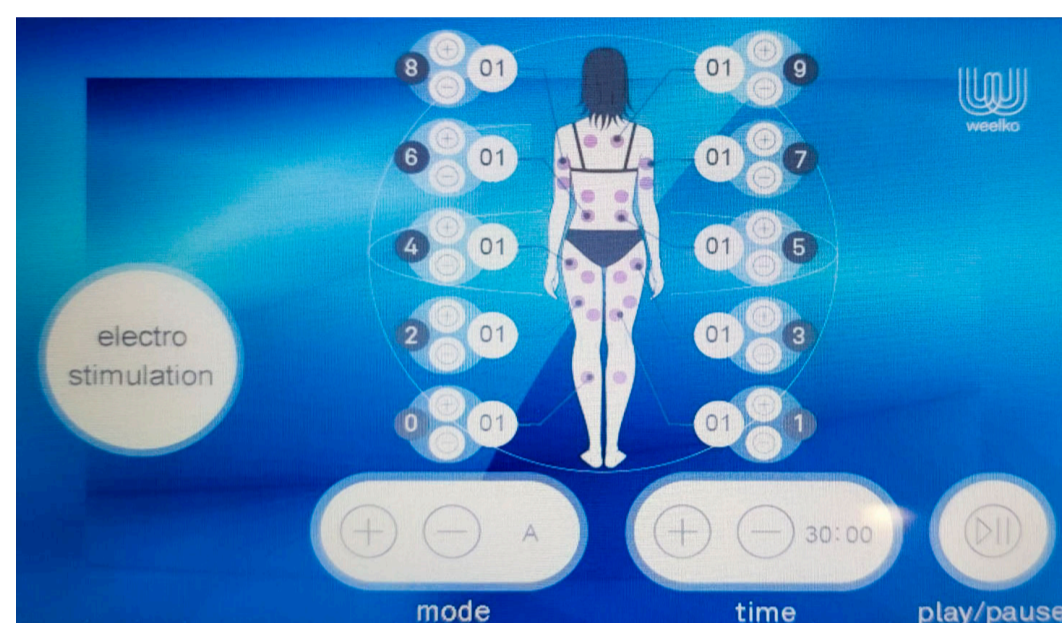

4. Le câble rouge est le pôle positif et il doit se placer sur le point moteur ou le ventre du muscle. Le câble noir sera le pôle négatif et il doit se placer sur l'électrode près de l'insertion du muscle. Appliquez du gel conducteur sur l'électrode avant de le mettre en contact avec la peau.

5. Utilisez les bandes élastiques afin de mieux fixer l'électrode à la zone à traiter.

6. Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton du panneau frontal et tapez sur le logo Weelko qui apparaît sur l'écran pour procéder à choisir les menus souhaités.

7. Sélectionnez le menu « Electrostimulation » pour commencer le traitement.

8. Le menu « LEVEL » règle l'intensité. Il permet d'ajuster de façon indépendante chaque électrode d'1 à 15. Dans le cas des programmes C et D, l'intensité est suffisante pour une activité fonctionnelle jusqu'à la contraction soit visible.

9. Le menu « TIME » permet de sélectionner le temps du traitement. Pour les programmes A et B le temps recommandé est 45 minutes. Pour les programmes C et D, le temps recommandé est 20-30 minutes maximum.

10. Appuyez sur « PLAY / PAUSE » pour commencer ou pauser le traitement.

PRÉCAUTIONS

• Pendant le traitement, vérifiez avec le patient si l'intensité du courant est appropriée.

• Assurez-vous que le courant est au minimum d'intensité avant d'appuyer sur PLAY. Augmentez l'intensité très progressivement.

• Ne retirez pas les électrodes de la peau avant d'éteindre complètement l'appareil.

ENTRETIEN

• Branchez et débranchez soigneusement les électrodes pour prolonger la durée de vie du produit. Seulement le câble d'alimentation sur la partie arrière de l'appareil doit être branché et débranché.




• Après chaque utilisation, nettoyez les électrodes avec un chiffon humide et un produit désinfectant.

ACCESSOIRES

REF.	DESCRIPTION
-	ÉLECTRODES TAILLE GRANDE
-	ÉLECTRODES TAILLE PETITE
-	EMS CÂBLE
-	EMS BANDES ÉLASTIQUES

SPÉCIFICATIONS

Poids et taille	Taille de l'emballage (cm)	52x45x23
	Poids brut (Kg)	8
	Dimensions produit (cm)	38x34x15
Caractéristiques de travail	Puissance nominale	50 W
	Puissance de travail	15 W
	Fréquence de travail EMS	10-40Hz
	Micro-courant pulsé EMS	50mA
Caractéristiques électriques	Tension nominale	220V ~ 240V
	Fréquence	50Hz/60Hz
	Puissance nominale	50 W

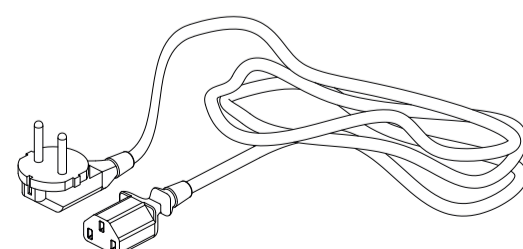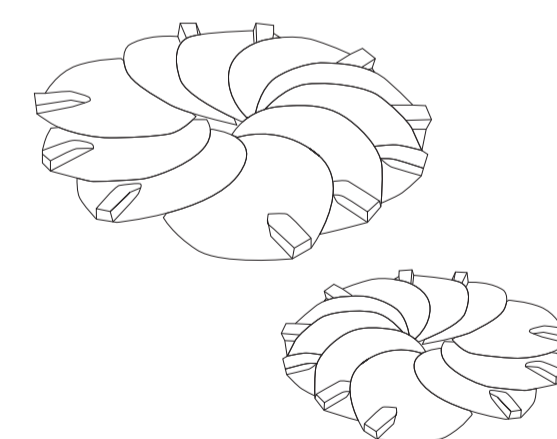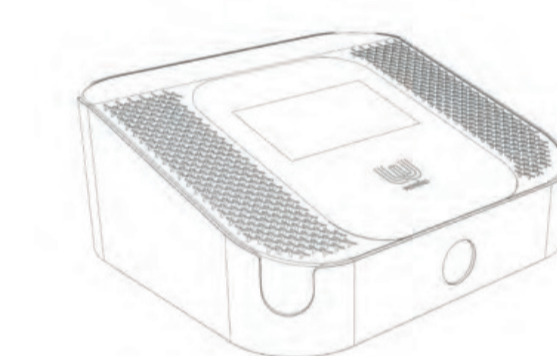



DE


WKB008
Instruction Manual
WE-2022-WKB008-1

ELEKTROSTIMULATION

PACKUNGSINHALT


- Diese Komponenten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Das Aussehen des Produkts kann von den Abbildungen abweichen..

No.	PRODUCT	REF.	QTÉ.
10	10 GROÙE ELEKTRODEN		10
11	10 KLEINE ELEKTRODEN		10
12	2 ANSCHLUSSKABEL MIT 10 AUSGÄNGEN	-	2
13	20 GUMMIBÄNDER MIT KLETTVERSCHLUSS	-	20
14	HAUPT-EINHEIT	-	1
15	VERSORGUNGSLEITUNG		1

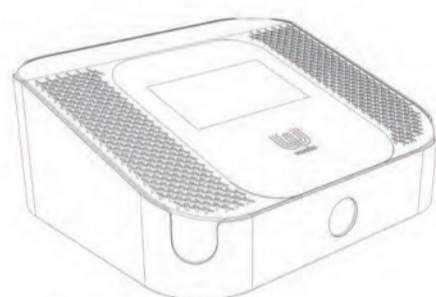

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Schließen Sie das Netzkabel an der Rückseite an.
2. Schließen Sie die Schläuche ordnungsgemäß an der Rückseite an. Folgen Sie die numerischen Anweisungen. Stecker mit Kabeln von 5 bis 9 ist links und von 0 bis 4 rechts zu stecken
3. Reinigen Sie bei den EMS-Elektroden die Haut mit etwas Alkohol, bevor Sie die Elektroden platzieren. Platzieren Sie sie an den gewünschten Stellen: Kleine Elektroden sind für kleine Bereiche wie Arme, Bauch und Schultern und große für Beine und Rücken.

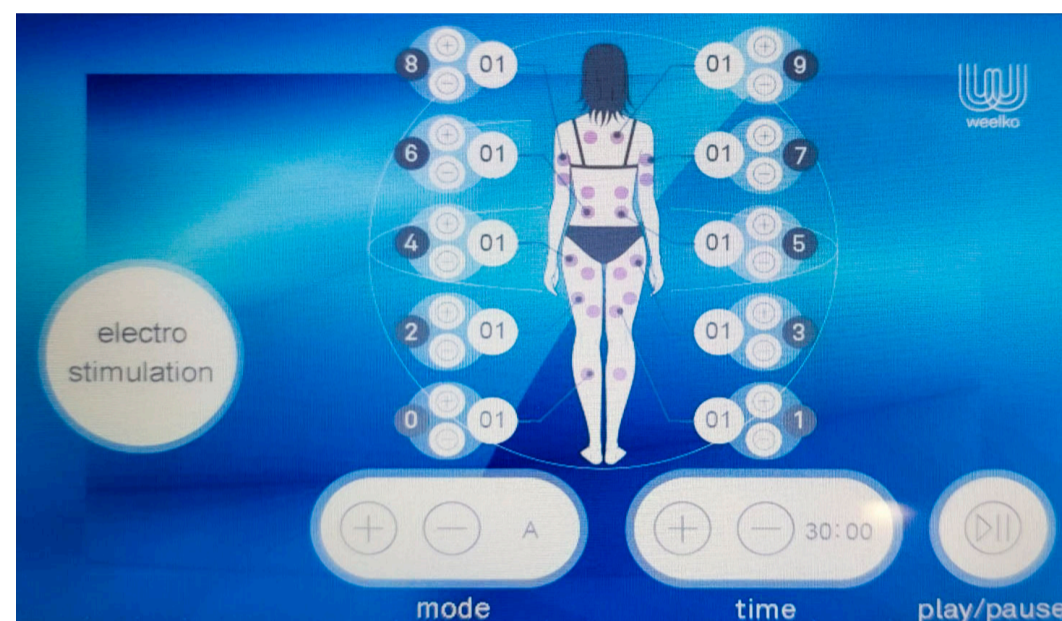

5. Verwenden Sie die elastischen Bänder, um die Elektroden in Kontakt mit der Haut zu halten.
6. Schalten Sie den Netzschalter auf der Vorderseite ein und klicken Sie auf das Weelko-Logo, um die gewünschten Menüs auszuwählen.
7. Wählen Sie das Menü „Elektrostimulation“ aus, um mit der Behandlung zu starten.

ACHTUNG

- Lassen Sie niemals den Anzug wärmen, wenn sich niemand darin befindet.
- Stellen Sie im Falle von EMS sicher, dass der Strom auf der minimalen Intensität ist, bevor Sie auf PLAY drücken, und erhöhen Sie die Intensität sehr progressiv.
- Entfernen Sie die Elektroden nicht von der Haut, bevor Sie das Gerät vollständig ausgeschaltet haben.

WARTUNG

- Reinigen Sie den Anzug nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch. Auch die Elektroden mit einem feuchten Tuch und etwas Desinfektionsmittel.
- Die Elektroden vorsichtig ein- und ausschließen, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern. Nur das allgemeine Netzkabel auf der Rückseite des Geräts soll angeschlossen und getrennt werden.

ZUBEHÖR

REF.	DESCRIPCIÓN
-	EMS BIG ELECTRODES
-	EMS SMALL ELECTRODES
-	EMS CABLE
-	EMS ELASTIC BELTS

WARNUNG

- Versuchen Sie niemals das Gerät zu öffnen und die innen liegenden Komponenten oder Zubehör zu untersuchen. Wenn eine Kontrolle notwendig wird, setzen Sie sich dafür mit Ihrem Lieferanten oder einem kompetenten Techniker in Verbindung.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in feuchter oder unbelüfteter Umgebung, wie z.B. Feuchträume oder Badezimmer, um Schaden an den elektrischen Komponenten Ihres Geräts zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien, Witterungseinflüsse können Schäden verursachen.


- Wenn die elektrische Zuleitung beschädigt ist, lassen Sie diese von einem Fachmann kontrollieren und austauschen, um Risiken zu vermeiden, oder bitten Sie den Händler um Kundendienstleistungen.
- Dieses Gerät darf nicht mit schwangeren Frauen, Patienten mit Epilepsie, Patienten mit Herzschrittmacher oder Hautinfektion verwendet werden.

EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen:

1. Die Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU
2. Die Vorschriften der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit: 2014/30/EU




RECYCLING

 Dieses Symbol auf unseren elektrischen Geräten und auf Ihren Verpackungen bedeutet, dass diese Produkte in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für die Entsorgung beachten Sie bitte die lokalen Vorschriften oder die Anforderungen für die Entsorgung von elektrischen Geräten. Diese Initiative zur Entsorgung von Elektromüll hilft die natürlichen Ressourcen zu erhalten und dient einem besseren Umweltschutz.

WILLKOMMEN!

Vielen Dank für Ihren Kauf! Bitte lesen Sie die Anleitungen gründlich durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie können auch Ihren Fachbetrieb um eine Einweisung bitten, damit Sie sicher sind, dass Sie das Gerät richtig einsetzen. Wir haften nicht für Unfälle, die aufgrund fehlerhafter Bedienung entstehen.

Der Hersteller behält sich technische Änderungen der Geräte ohne vorherige Ankündigung vor. Wenn Sie in diesen Anleitungen Fehler finden, bitte senden Sie uns eine E-Mail, damit wir diese berichtigen können.

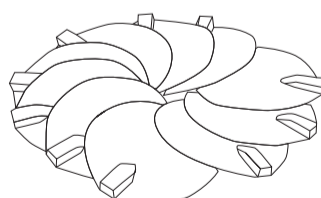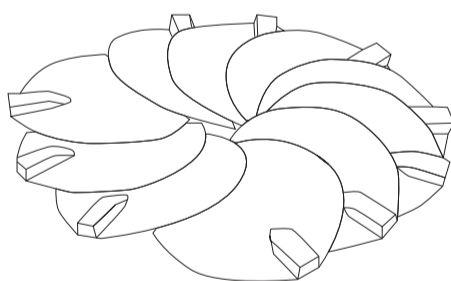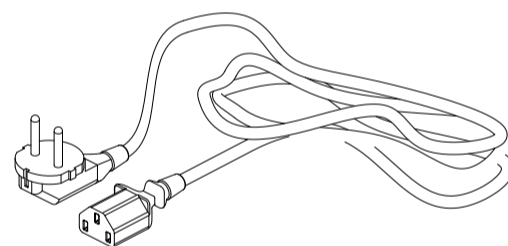

4. Das rote Kabel ist der Pluspol und muss auf den Motorpunkt oder den Muskelbauch gelegt werden. Das schwarze Kabel ist den Minuspol und wird nahe am Muskelansatz an der Elektrode platziert. Tragen Sie leitfähiges Gel auf die Elektrode auf, bevor Sie sie mit der Haut in Kontakt bringen. Verwenden Sie die elastischen Bänder, um die Elektroden in Kontakt mit der Haut zu halten.

DATENBLATT

Gewicht und Abmessungen	Verpackungsgröße (cm)	52x45x23
	Bruttogewicht (Kg)	8
	Produktabmessungen (cm)	38x34x15
Technische Daten	Nennleistung	50 W
	Leistung	15 W
	Arbeitsfrequenz EMS	10-40Hz
	Gepulster Mikrostrom EMS	50mA
Elektrische Daten	Nennspannung	220V ~ 240V
	Frequenz	50Hz/60Hz
	Nennleistung	50 W